

クイックチェイサー® Adeno 眼 各種変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「クイックチェイサー® Adeno 眼」につきまして、下記事項を変更いたしますのでご案内申し上げます。

当分の間は、新旧製品が流通しご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

<変更内容>

- ・従来の目視に加え、専用機器「スマートQCリーダー※」による判定が可能になります。
- ・外装箱のサイズ及びデザインを変更します（図2参照）。
- ・テストプレートの形状、デザイン（図3参照）およびアルミパウチのデザインを変更します。
- ・抽出液用アルミパウチに英語表示を追記します。
- ・抽出液の一時保存用の青色キャップを半透明のキャップに変更します（図4参照）。
- ・スタンド（抽出液用）とネームシールの添付を廃止します。
- ・添付文書の記載を一部変更します。

※スマートQCリーダーは、2021年5月末の発売を予定しています。

<変更品出荷予定時期>

出荷時期につきましては、以下のとおり予定しておりますが、流通在庫の関係から前後することもございます。何卒ご了承願います。

変更品の出荷スケジュールにつきましては、弊社ホームページ（<https://www.nitten-eye.co.jp/medical/central/>）にてお知らせいたします。

販売名	包装	統一商品コード	GS1-RSS コード	製造番号 (使用期限)	出荷予定時期
クイックチェイサー® Adeno 眼	10 回用	421-602111	(01)04987421 602111	0031A (2022 年 2 月)	2021年5月下旬

裏面もご参照ください。

図1 製品全体

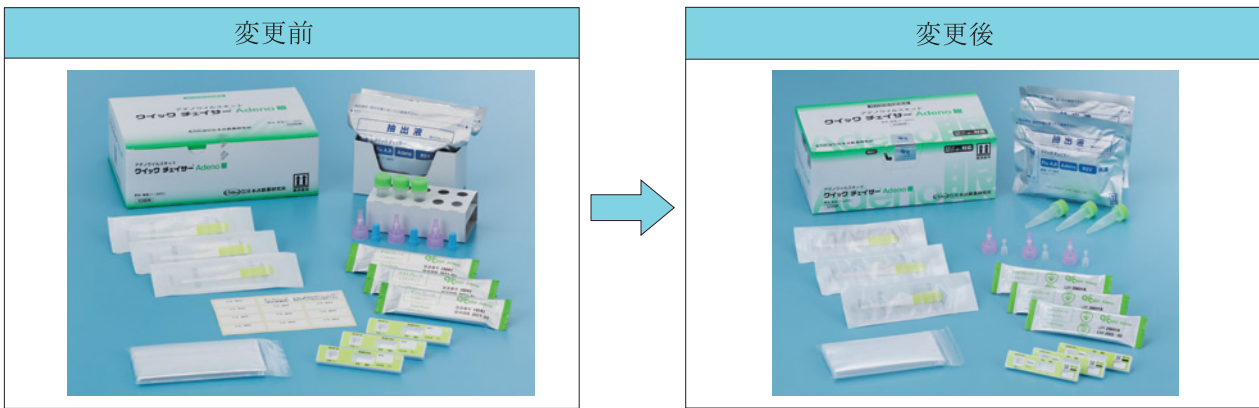


図2 外装箱デザイン

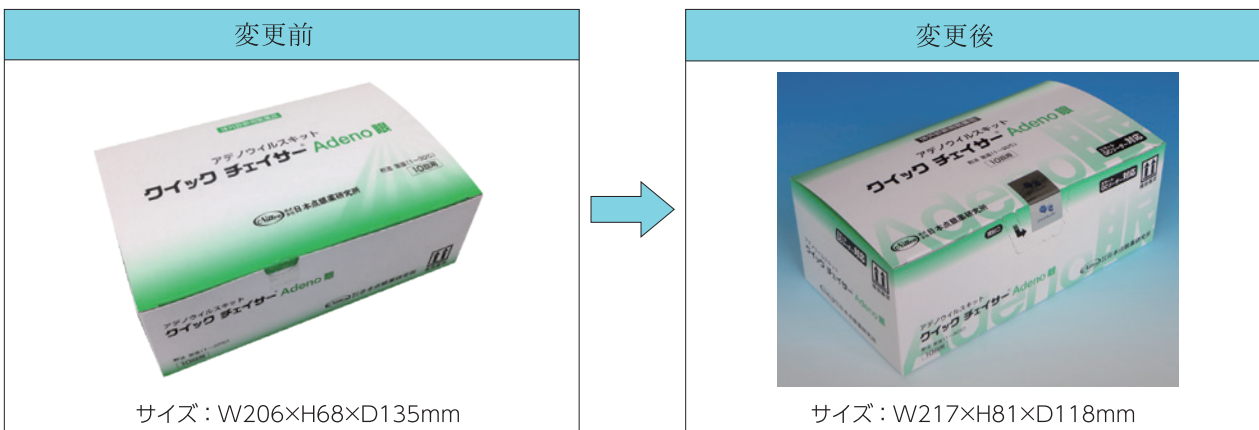


図3 テストプレートデザイン

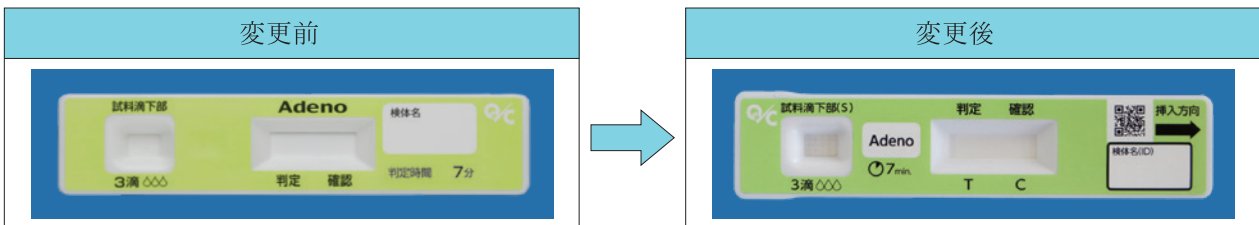


図4 フィルターキャップ

